


## Restaurations antérieures

## Restaurations postérieures

### IPS e.max®


#### COURONNE UNITAIRE

##### Préparation pour couronne antérieure

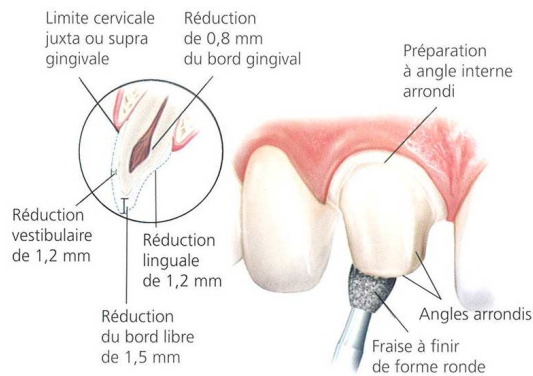

#### BRIDGE 3 ÉLÉMENTS


##### Préparation pour bridge 3 éléments

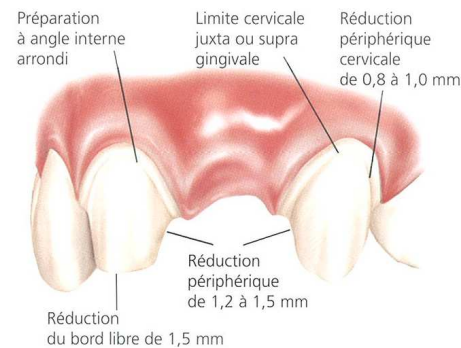

#### FACETTE


##### Préparation pour facette

Une fraise diamantée à extrémité arrondie et à grain moyen est utilisée pour retirer une couche uniforme d'émail.

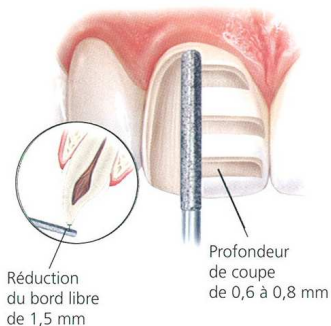


##### Préparation pour facette pelliculaire

Grâce à IPS e.max, il est possible de réaliser des facettes pelliculaires qui peuvent être collées sur les dents préparées à minima. Si la place est suffisante, aucune préparation n'est nécessaire. Respecter une épaisseur minimale de 0,3 mm dans les zones cervicale et vestibulaire et de 0,4 mm au bord incisif.

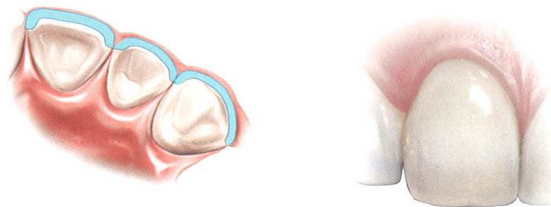


#### INLAY / ONLAY

##### Préparation pour inlay


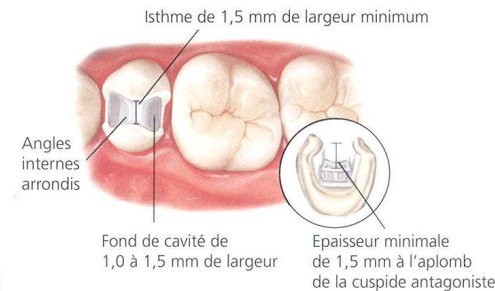


##### Préparation pour onlay

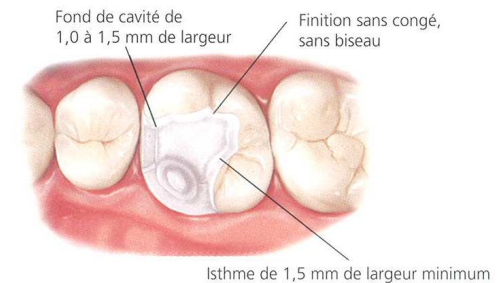


#### BRIDGE 3 ÉLÉMENTS

##### Préparation pour bridge 3 éléments

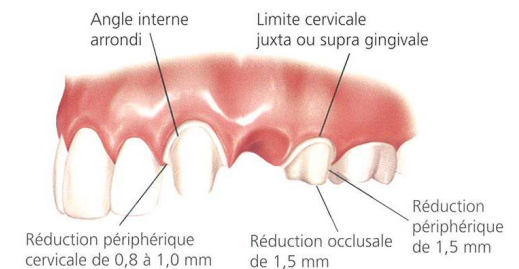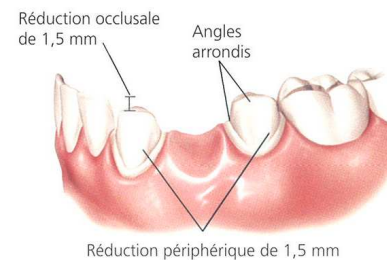

#### COURONNE UNITAIRE

##### Préparation pour couronne postérieure

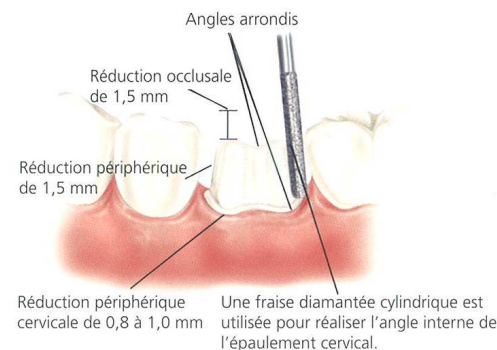

##### Préparation en vue d'un scellement

